

TOE F.A.S.T.[®]



TECHNIQUE OPÉRATOIRE

 serf
EXTREMITIES

S O M M A I R E

TECHNIQUE OPÉRATOIRE	4
IMPLANTS & ANCILLAIRE	10
PRODUITS ASSOCIÉS	11
GAMME EXTREMITIES	12

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

1 RÉSECTION ARTICULAIRE



Réséquer la surface articulaire de la phalange.

COUPE DROITE
PAR RAPPORT À L'AXE PHALANGIEN



COUPE ANGULÉE
PAR RAPPORT À L'AXE PHALANGIEN



Résection articulaire des surfaces articulaires de P2




2 PRÉPARATION DE LA PHALANGE PROXIMALE

COUPE DROITE



Le point d'insertion
doit être centré

COUPE ANGULÉE

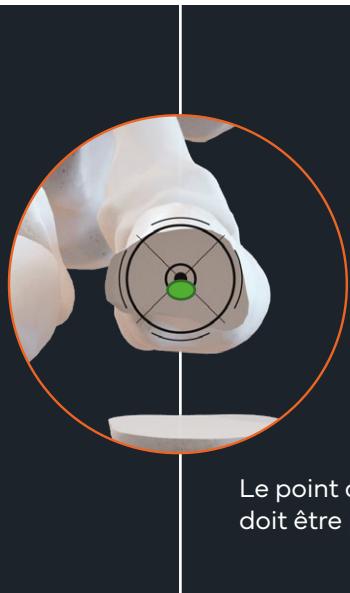

Le point d'insertion
doit être plus plantaire

Préparer le fût centro-médulaire perpendiculaire à la coupe articulaire de manière croissante à l'aide du compacteur.

La préparation doit être incrémentale en commençant par la taille S et jusqu'à la butée.

Attention : ne pas rechercher l'appui cortical, rester en spongieux.



3

PRÉPARATION DE LA PHALANGE DISTALE

COUPE DROITE ET ANGULÉE



Préparer le fût centro-médulaire de manière croissante à l'aide du compacteur en commençant par la taille S et jusqu'à la butée.

4

MISE EN PLACE DES IMPLANTS

- 1 En premier, insérer manuellement avec le tournevis mâle l'implant femelle dans la préparation de la phalange proximale.

COUPE DROITE





COUPE ANGULÉE



Il est important que l'implant soit bien positionné :

- ✓ L'implant est légèrement débordant
- ✗ Attention : l'implant ne doit pas être plus bas que la coupe.

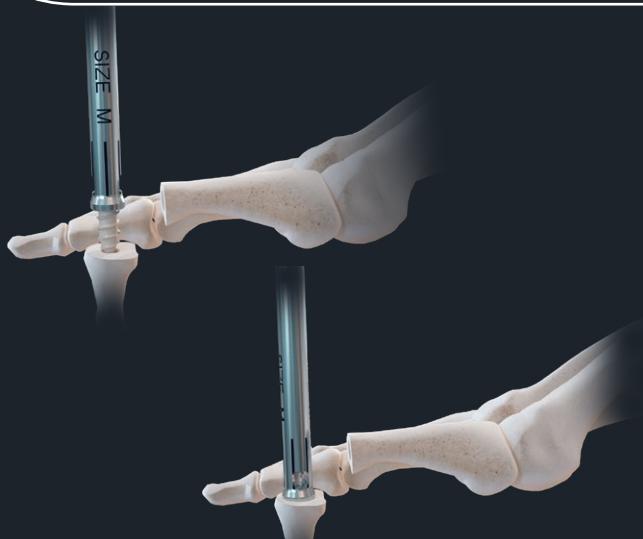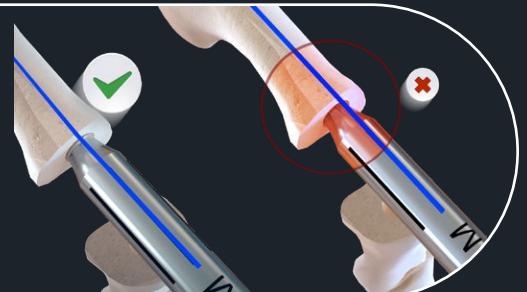

- 2 Dans un second temps, insérer manuellement avec le tournevis femelle, l'implant mâle dans la préparation de phalange distale.

- 3 Stopper le vissage lorsque le tournevis est en contact avec la coupe.
Positionner l'un des repères du tournevis soit vertical ou horizontal.

5 RÉDUCTION DE LA PHALANGE DISTALE

COUPE DROITE ET ANGULÉE



1 Il est très important que les empreintes des pièces mâles et femelles soient alignées.




2 Rechausser la phalange distale sur la phalange proximale, jusqu'à entendre le click.
Si le clippage ne se fait pas, dévisser légèrement la pièce proximale.




Il est fortement recommandé de réaliser une ténotomie de l'extenseur.

6 OPTION : OSTEOTOMIE BASALE PLANTAIRE PERCUTANÉE

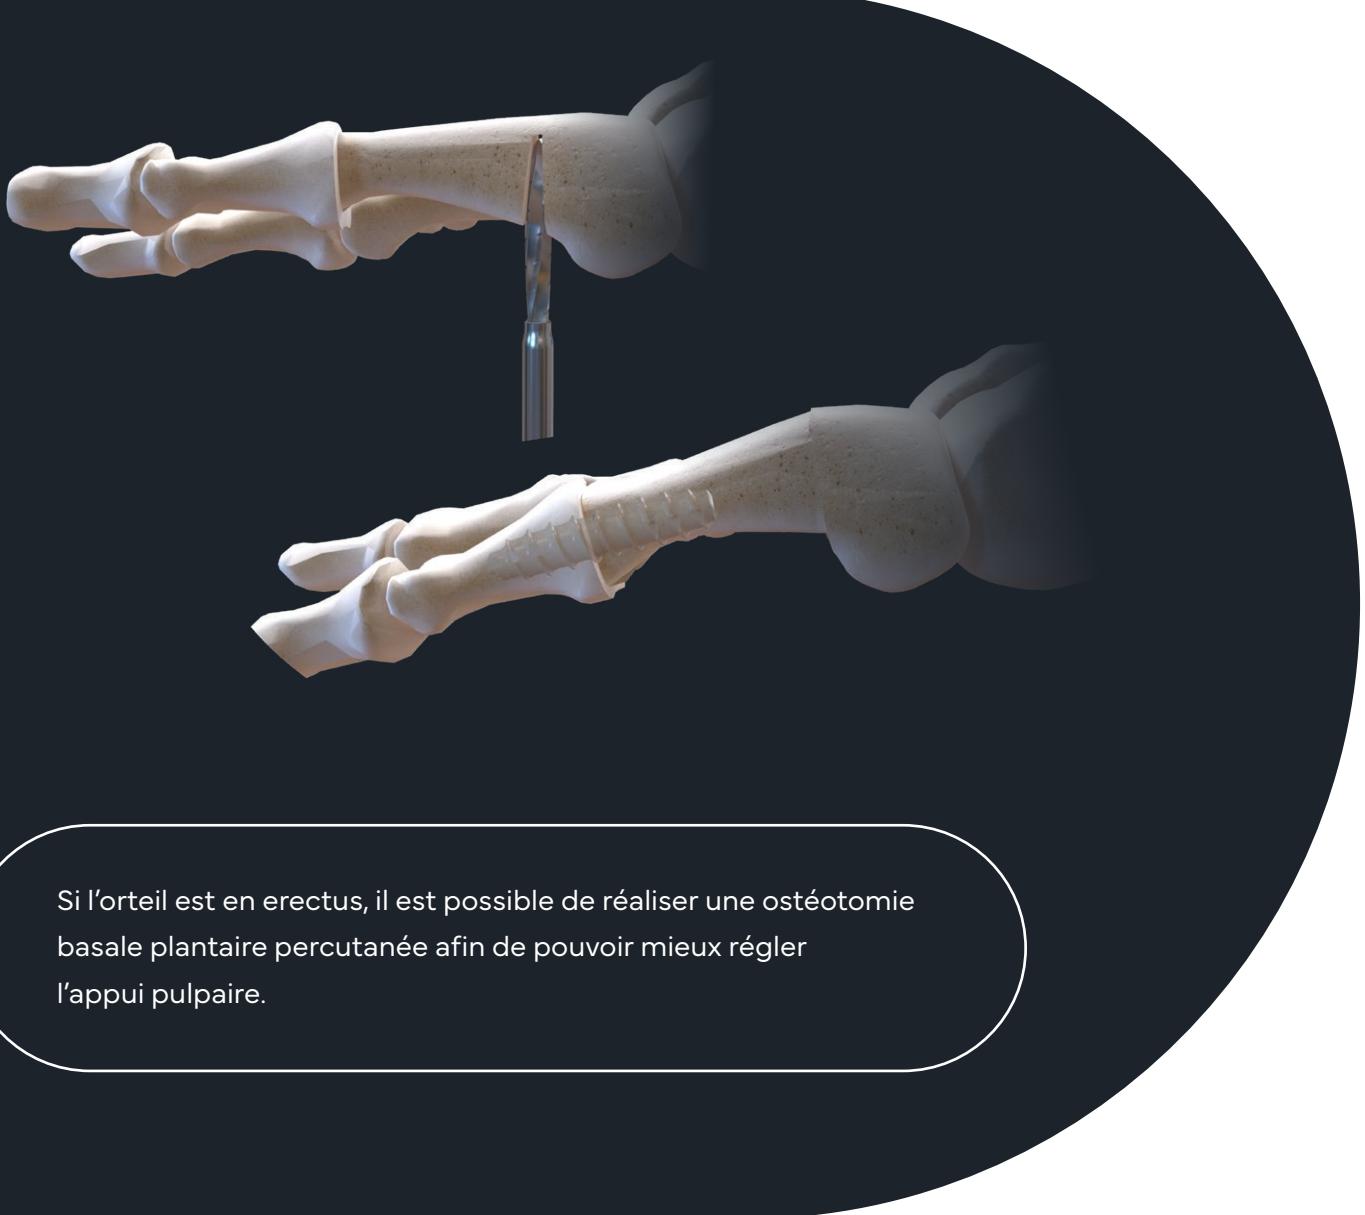

Si l'orteil est en *erectus*, il est possible de réaliser une ostéotomie basale plantaire percutanée afin de pouvoir mieux régler l'appui pulinaire.

IMPLANTS & ANCILLAIRE

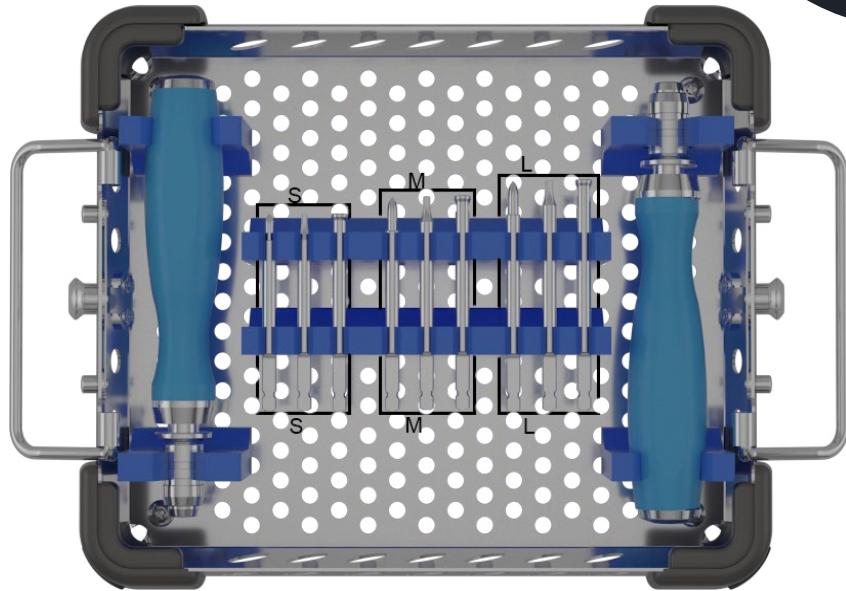

IMPLANTS

GS1	LIBELLÉ
3663165004817	Toe F.A.S.T.® Taille S
3663165004824	Toe F.A.S.T.® Taille M
3663165004831	Toe F.A.S.T.® Taille L

KIT TOE F.A.S.T.® VASET™

GS1	LIBELLÉ
3663165004930	Panier Toe F.A.S.T.®
3663165004947	Couvercle Toe F.A.S.T.®
3663165004848	Tournevis Mâle Taille S
3663165004855	Tournevis Mâle Taille M
3663165004862	Tournevis Mâle Taille L
3663165004879	Tournevis Femelle Taille S
3663165004886	Tournevis Femelle Taille M
3663165004893	Tournevis Femelle Taille L
3663165004909	Compacteur Taille S
3663165004916	Compacteur Taille M
3663165004923	Compacteur Taille L
3663165003490	Poignée Encliquetage AO

PRODUITS ASSOCIÉS

Ø 2.7

GS1	LIBELLÉ
	FAST Ø 2.7 L12 3663165003728
	FAST Ø 2.7 L14 3663165002165
	FAST Ø 2.7 L16 3663165002172
	FAST Ø 2.7 L18 3663165002189
	FAST Ø 2.7 L20 3663165002196
	FAST Ø 2.7 L22 3663165002202
	FAST Ø 2.7 L24 3663165002219
	FAST Ø 2.7 L26 3663165002226
	FAST Ø 2.7 L28 3663165002233
	FAST Ø 2.7 L30 3663165002240


GAMME EXTREMITIES



VIS F.A.S.T.[®]



VIS SÉCABLES

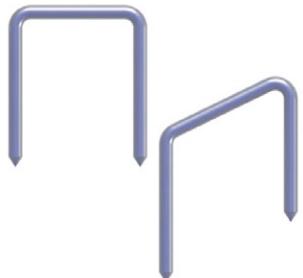

AGRAFES



FRAISES PERCUTANÉES



PLAQUES F.A.S.T.[®]

ACCÈS À LA NOTICE D'INSTRUCTIONS DÉMATÉRIALISÉE

SERF met à votre disposition, pour chaque type d'implant, des notices d'instructions dématérialisées spécifiques, régulièrement mises à jour, consultables, téléchargeables et imprimables au gré de vos besoins.

La notice correspondante peut vous être envoyée, sur support papier dans un délai de 7 jours calendaires, sur simple demande auprès de **SERF**.

Vous trouverez dans ces notices non seulement les informations règlementaires et les caractéristiques techniques de nos implants, mais également de précieuses informations sur les indications, contre-indications, compatibilités entre implants, les examens possibles et ceux à rigoureusement éviter, etc.

Ces notices dématérialisées, au format Adobe® Acrobat® PDF, sont accessibles et téléchargeables de deux manières :

- à partir d'un QR code figurant sur l'emballage de l'implant, pouvant être lu à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (connexion Internet requise ; 3G/4G, Wi-Fi...) et d'une application de lecture appropriée (disponible en téléchargement gratuit sur Google Play, Apple® Appstore et Windows® Store selon modèle de périphérique employé),

- via la connexion Internet d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette, en saisissant directement sur votre navigateur Internet usuel l'adresse URL indiquée à proximité du QR code.

Voici les QR code et adresses URL des notices d'instructions dématérialisées :



FAST® VIS



<http://doc.serf.fr/0212.pdf>



VIS SÉCABLES



<http://doc.serf.fr/0211.pdf>



TOE FAST



<http://doc.serf.fr/0214.pdf>



FAST® PLAQUES



<http://doc.serf.fr/0213.pdf>



AGRAFES



<http://doc.serf.fr/0209.pdf>

Système d'exploitation requis Acrobat Reader DC

Windows

- Processeur de 1,5 GHz ou plus rapide
- Windows Server 2008 R2 (64 bits), 2012 (64 bits), 2012 R2 (64 bits)* ou 2016 (64 bits) ; Windows 7 SP1 (32 et 64 bits), Windows 8, 8.1 (32 et 64 bits)* ou Windows 10 (32 et 64 bits)
- 1 Go de mémoire RAM
- 380 Mo d'espace disponible sur le disque
- Résolution d'écran 1024x768
- Internet Explorer 11

MacOS

- Processeur Intel
- Mac OS X v10.11, macOS v10.12, macOS v10.13 ou macOS v10.14*
- 1 Go de mémoire RAM
- 380 Mo d'espace disponible sur le disque
- Résolution d'écran 1024x768
- Safari 9.0, 10.0 ou 11.0 (Le module externe pour Safari est uniquement pris en charge par les systèmes 64 bits dotés d'un processeur Intel.)

Applications mobiles

- Adobe Acrobat Reader : iOS, Android, Windows Phone
- Adobe Scan : iOS, Android
- Adobe Fill & Sign : iOS, Android

NOTES

Tous les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont marqués CE selon la Directive 93/42/CEE et ses amendements, à moins qu'identifiés spécifiquement comme «non marqués CE». Les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont des dispositifs de classe IIb et Ila. Les dispositifs médicaux de classe IIb et Ila sont marqués CE 0459 avec le GMED. Avant toute utilisation d'un produit SERF, veuillez vous référer à la notice d'instructions et à la technique opératoire. Consulter les étiquettes et notices produits pour la liste complète des indications, contre-indications, risque, avertissement, précautions et mode d'emploi.
©2023 SERF. Tous droits réservés. F.A.S.T.® est une marque de commerce de SERF.

DISTRIBUÉ PAR



serf